



ROBOTIP™ G2

Surgilum, LLC Model TPSG2 (RoboTip G2) for exclusive use with Surgilum, LLC Model RMSG2 (RoboMarker G2) – sold separately

Instructions for Use

Congratulations! Thank you for purchasing your Box of RoboTip G2. Please read these instructions carefully to achieve the best possible results.


Description: The single use TPSG2 RoboTip is used with the reusable RMSG2 RoboMarker Handle to apply reference marks at a prescribed axis angle to the surface of the cornea or adjacent corneal/scleral junction. The handle maintains marking tip angular position using an enclosed pendulum system and includes a fixation light, projected laser target alignment lines, and an axis dial brake to aid in corneal axis mark placement.

Indications for Use: The RoboMarker G2 (RMSG2) and the RoboTip G2 (TPSG2) are used in combination as a corneal marking system. The system places highly accurate marks on the cornea as well as the peripheral corneal/scleral junction for Toric Intracocular Lens alignment, Femto-Laser Cataract Surgery, Limbal Relaxing Incisions, and other refractive ocular procedures.

Specifications:

- Physical: 25mm X 39mm X 8mm, 1g
- Materials: Proprietary dry ink formula of Gentian Violet (Crystal Violet) and Carbon on a Polycarbonate Carter Tip and a XLPE protective cap.
- Packaging: Poly/Paper sealed pouch with tear notches.
- Mark Geometry: Dots – 1.2mm lines spaced by 7.5mm internal optical zone
- Sclera – 1.2mm lines spaced by 12mm internal optical zone
- Sterility: Radiation, Gamma, ISO 11137 VDmax25

Part Identification

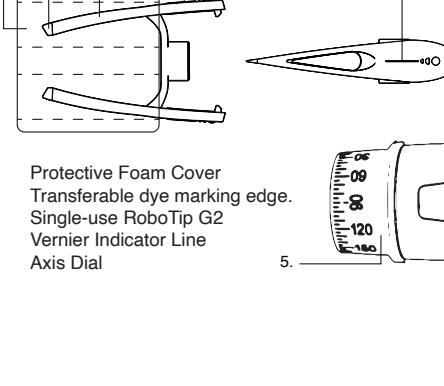

Surgilum, LLC Model TPSG2 (RoboTip G2) zur ausschließlichen Verwendung mit Surgilum, LLC Modell RMSG2 (RoboMarker G2) – wird gesondert verkauft.

Gebrauchsanweisung

Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank, dass Sie sich für eine Packung RoboTip G2 entschieden haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, um bestmögliches Ergebnisse zu erzielen.


Beschreibung: Die Einweg-TPSG2 RoboTip wird zusammen mit dem wiederverwendbaren RMSG2 RoboMarker Griff zum Setzen von Referenzmarkierungen in einem verschiedenen Achsenwinkel auf der Oberfläche des Hornhaut und im benachbarten Übergangsbereich zwischen Hornhaut und Lederhaut verwendet. Der Griff hält die Winkelposition der Markierungsstange mit Hilfe eines Pendelsystems bei. Darüber hinaus verfügt der Griff zur Unterstützung für das Setzen von Markierungen in der Hornhautschuppe über ein Fixierungssicht, projizierte Ausrichtungslinien für das Laserziel und eine Bremsel und linsenförmige Entlastungsschritte und andere reflektive Augenverfahren.

Indikationen für die Verwendung: Der RoboMarker G2 (RMSG2) und die RoboTip G2 (TPSG2) werden zusammen als Hornhaut-Markierungsstange verwendet. Das System setzt hochpräzise Markierungen an der Hornhaut sowie an den seitlich davon liegenden Übergangsbereichen Hornhaut und Lederhaut für die Ausrichtung torischer Intrakularlinsen, Kataraktoperationen mit Femtosekundenlaser, limbusnahe Entlastungsschritte und andere reflektive Augenverfahren.

Spezifikationen:

- Physical: 25 mm x 39 mm x 8 mm, 1 g
- Materials: Unsernehmenseigene Formulierung einer Trockenfarbe aus Enzianviolett (Kristallviolett) und Kohlenstoff auf einer Trägermatrix aus Polycarbonat und einer Schutzkappe aus XLPE.
- Verpackung: Versiegelter Beutel aus Poly/Papier mit Einzelkernen.
- Geometrie: Hornhaut – 1.2 mm Linien getrennt durch eine 7.5 mm breite interne optische Zone
- Lederhaut – 1.2 mm Linien getrennt durch eine 12 mm breite interne optische Zone
- Sterilität: Gammabestrahlung gemäß ISO 11137 VDmax25

Teilezeichnung

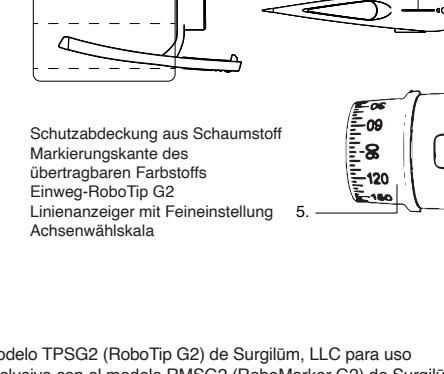

Modelo TPSG2 (RoboTip G2) de Surgilum, LLC para uso exclusivo con el modelo RMSG2 (RoboMarker G2) de Surgilum, LLC. Se venden por separado.

Instrucciones de uso

Jefatura: ¡Gracias por comprar la caja de puntas RoboTip G2. Lea estas instrucciones detalladamente para lograr los mejores resultados posibles.


Descripción: La TPSG2 RoboTip de un solo uso se utiliza con el mango reutilizable RMSG2 RoboMarker para aplicar marcas de referencia en un eje de precisión sobre la superficie de la córnea o la unión esclerocorneal adyacente. El mango mantiene la posición angular de la punta de marcado mediante un sistema de péndulo cerrado e incluye una luz de fijación, líneas de alineación del objetivo láser proyectado y un freno de la rueda de ejes que facilita la colocación de las marcas del eje de eje.

Indicaciones de uso: El RoboMarker G2 (RMSG2) y la RoboTip G2 (TPSG2) se utilizan en combinación como sistema de marcado corneal. El sistema sitúa marcas muy precisas en la córnea, así como en la unión esclerocorneal periférica, para la alineación de lentes intraculares toricas, intervenciones quirúrgicas de cataratas con láser de femtosegundo, incisiones limbaras relajantes y otros procedimientos refractivos oculares.

Especificaciones:

- Físicas: 25 mm x 39 mm x 8 mm, 1 g
- Materiales: Fórmula patentada de colorante seco de violeta de genciana (crystal violet) y carbono en una punta portadora de polícarbonato y un tapón protector de XLPE.
- Envase: Bolsa cerrada de polipapel con muescas para rasgar.
- Geometría: Líneas de 1.2 mm espaciadas por una zona óptica interna de 7.5 mm.
- Esclera: Líneas de 1.2 mm espaciadas por una zona óptica interna de 12 mm.
- Sterilidad: Radiación, gamma, ISO 11137 VDmax25

Identificación de la pieza

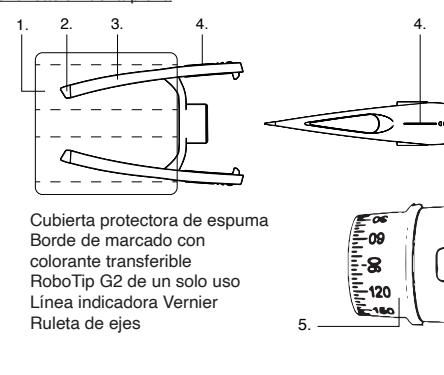

Contraindicaciones: DO NOT USE ROBOMARKER G2, ROBOTIPS G2, WITH ANY PATIENT THAT HAS SENSITIVITY OR ALLERGY TO GENTIAN VIOLET (CRYSTAL VIOLET) DYE.

ONLY USE THE G2 ROBOMARKER SYSTEM ON HEALTHY CORNEAS. DO NOT USE ON INFANTS.

CAUTION:

- The RoboMarker G2 should only be used by healthcare professionals.
- The RoboMarker G2 and RoboTip G2 are precision instruments and must be handled with care to prevent damage that will adversely affect marking accuracy.
- Only use RoboMarker G2 and RoboTip G2 for its intended use and as directed within these instructions.
- The Single-use RoboTip G2 is sterile via Gamma Radiation and intended for single use ONLY. Do NOT attempt to re-sterilize or re-use on more than one patient.
- Do NOT use RoboTip G2 if the sterile pouch is damaged.

Compatibility: The RoboTip G2 is only compatible with the RoboMarker G2 handle (produced and sold separately by Surgilum, LLC). Do not attempt to use the RoboMarker G2 or RoboTip G2 with other marking systems.

CAUTION: RoboTip G2 is a light-sensitive product. Protect from light exposure until the day of use. The RoboTip G2 is a STERILE component that should never be re-used.

Marking Posture: The RoboMarker G2 handle is a pendulum/gravity-based device that must be held HORIZONTALLY for accurate marking. The RoboTip G2 must be inserted on the RoboMarker G2 handle in accordance with the product instructions. Once the RoboTip G2 is properly inserted on the RoboMarker G2 handle, the single-use RoboTip G2 is directed towards the patient who should be in an upright position with their head similar to an upright tilt lamp position (or positioned like it was when the patient's K Readings were obtained).

CAUTION: RoboMarker cannot be oriented vertically such as with a patient in a supine position. Any attempt to do so will result in inaccurate mark placement due to ocular cyclotorsion and loss of pendular gravitational effect.

Inserting a single-use RoboTip G2 into the RoboMarker G2:

NOTE: The RoboTip G2 is a 2-position marking tip. The shifted position is the peripheral corneal/scleral marking position. To achieve an inner corneal marking position, press down between the marking edges after the tip cylinder has been seated into the G2 axial dial receptacle.

1. Open the pouch and remove the single-use RoboTip

2. G2 by the Protective Foam Cover (1). Do not remove the Protective Foam Cover at this time as it may contaminate the dye marking edge of the G2 tip.

3. Insert the stem of the RoboTip G2 into the receptacle in the center of the Axis Dial (5).

4. Remove the Protective Foam Cover (1)

5. Initial placement of the RoboTip G2 onto the G2 achieves the peripheral corneal/scleral marking position.

To achieve an inner corneal marking position, press down between the marking edges; AVOID TOUCHING THE MARKING EDGES (2).

6. Place the RoboMarker G2 handle with inserted G2 tip in your dominant hand leaving your index finger free.

7. Using your index finger, press and hold the Mode Button on the RoboMarker G2 for 3 seconds in order to illuminate the Axis Dial. The device is in "Axis Dial Mode".

8. Use your thumb and forefinger to stabilize the axis dial to rotate the RoboTip G2 until the Vernier line indicator on the RoboTip G2 is aligned with the desired axis degree on the now illuminated Axis Dial.

DO NOT USE THE AXIS BRAKE BUTTON THAT IS NEAR THE AXIS DIAL TO STABILIZE THE DIAL DURING ROTATION OF THE ROBOTIP. DOING SO WILL DAMAGE THE BRAKE FUNCTION OF THE AXIS DIAL BRAKE.

Corneal Marking Procedure: ENSURE YOUR PATIENT'S EYE IS NUMBER ONE! Even if the patient recently received numbing drops, additional numbing drops are highly recommended just before corneal marking with the RoboMarker G2 marking system.

With the RoboMarker G2 Handle on, use your index finger briefly press the Mode Button to place the unit into "Laser Target Mode". This will project the laser target and the Mode and Brake buttons will flash in 1 second intervals.

NOTE: The RoboMarker G2 has an accelerometer

9. Place the RoboMarker G2 handle with inserted G2 tip in your dominant hand leaving your index finger free.

10. Inform the patient that you will be using a blinking laser fixation target along with other instruments that may be used in their surgery.

11. You may want to inform your patient they might feel momentary mild pressure but that they MUST continue to look at the fixation light.

12. Instruct the patient to blink the eye once to moisten the cornea. Then use your other hand to gently hold open the patient's eyelid.

13. Position the RoboMarker G2 at cheek level below the patient's eye.

14. While lifting the G2 from below the eye to be marked up to a position approximately 2 inches (5cm) from the center of the cornea, instruct the patient to look at the 10-linking centric dot of the laser target. The projection of the laser target on the eye will allow you to fine-tune the centration of the RoboMarker G2 tips over the cornea as the marking tips approach the cornea.

CAUTION: If the marking tips do not land simultaneously, a rotation or a "pirouetting" of the marking tips may occur on touchdown. To prevent this, the RoboMarker G2 includes a forward Axis Dial Brake button.

15. After marking the cornea, keep the eyes open for 10 seconds to allow the dye to set. Then instruct the patient to keep both eyes CLOSED until surgery to avoid blinding off the marking dye.

(Placing a light towel over both eyes of the patient will discourage blinking and help the marks to remain defined.)

16. Squeeze front of tip together to remove single-use RoboTip G2. Turn off the RoboMarker G2 Handle by pressing and holding the Mode Button for 3 seconds.

17. Safely dispose of used tips in accordance with your waste procedures.

Note: RoboTip G2 tips are recyclable.

Storage and Cleaning: Unused RoboTip G2s must remain sealed in their original sterilized pouch and stored in a dry area in the original open pack box as the box label includes important tip batch number and the expiration date information.

Environmental Limitations

Use +10C -35C (50F - 95F), <90% RH

Storage & Transportation -10C -35C (14F - 130F), <95% RH

Maintenance & Service: The RoboTip G2 is a single use device and should not be re-used. There is no maintenance/service required for the RoboTip G2.

CAUTION: Single-use RoboTips G2 should not be used after the expiration date printed on the over pack box.

CAUTION: Single-use RoboTips G2 CAN NOT be reused. Any attempt to do so may cause harm or injury.

Recommendation: Practice using the RoboMarker G2 before surgery on a conventional object of similar size to

detect whether the G2 handle is level. When the projected target is "steady" (not flashing) the G2 handle is slightly out of linear alignment however, reasonably good marks may be obtained but note that these marks may have a slight "A" or "V" configuration.

If the projected laser target is blinking, the device is slightly out of linear alignment however, reasonably good marks may be obtained but note that these marks may have a slight "A" or "V" configuration.

NOTE: The projected laser target will turn off if the G2 handle is not level enough to obtain reasonably accurate corneal marking.

9. Hover your index finger above the brake button.

10. Inform the patient that you will be using a blinking laser fixation target along with other instruments that may be used in their surgery.

11. You may want to inform your patient they might feel momentary mild pressure but that they MUST continue to look at the fixation light.

12. Instruct the patient to blink the eye once to moisten the cornea. Then use your other hand to gently hold open the patient's eyelid.

13. Position the RoboMarker G2 at cheek level below the patient's eye.

14. While lifting the G2 from below the eye to be marked up to a position approximately 2 inches (5cm) from the center of the cornea, instruct the patient to look at the 10-linking centric dot of the laser target. The projection of the laser target on the eye will allow you to fine-tune the centration of the RoboMarker G2 tips over the cornea as the marking tips approach the cornea.

CAUTION: If the marking tips do not land simultaneously, a rotation or a "pirouetting" of the marking tips may occur on touchdown. To prevent this, the RoboMarker G2 includes a forward Axis Dial Brake button.

15. After marking the cornea, keep the eyes open for 10 seconds to allow the dye to set. Then instruct the patient to keep both eyes CLOSED until surgery to avoid blinding off the marking dye.

(Placing a light towel over both eyes of the patient will discourage blinking and help the marks to remain defined.)

16. Squeeze front of tip together to remove single-use RoboTip G2. Turn off the RoboMarker G2 Handle by pressing and holding the Mode Button for 3 seconds.

17. Safely dispose of used tips in accordance with your waste procedures.

Note: RoboTip G2 tips are recyclable.

Storage and Cleaning: Unused RoboTip G2s must remain sealed in their original sterilized pouch and stored in a dry area in the original open pack box as the box label includes important tip batch number and the expiration date information.

Environmental Limitations

Use +10C -35C (50F - 95F), <90% RH

Storage & Transportation -10C -35C (14F - 130F), <95% RH

Maintenance & Service: The RoboTip G2 is a single use device and should not be re-used. There is no maintenance/service required for the RoboTip G2.

CAUTION: Single-use RoboTips G2 should not be used after the expiration date printed on the over pack box.

CAUTION: Single-use RoboTips G2 CAN NOT be reused. Any attempt to do so may cause harm or injury.

Recommendation: Practice using the RoboMarker G2 before surgery on a conventional object of similar size to

the cornea. Many surgeons will use a grape. Limited Warranty: RoboMarker G2 and single-use RoboMarker G2 Tips are warranted to be free of defects in materials and workmanship. If any defects are discovered please notify Surgilum, LLC.

Modèle Surgilum, LLC TPSG2 (RoboTip G2) pour un usage exclusif avec le modèle Surgilum, LLC RMSG2 (RoboMarker G2) – vendu séparément

Notice

Fabrication : Nous vous remercions d'avoir acheté le RoboTip G2. Veuillez lire ces instructions avec attention afin d'atteindre des résultats optimaux.


Description : Le RoboTip G2 à usage unique est utilisé avec la poignée réutilisable RoboMarker G2 pour appliquer des marques de référence pour l'opération de cataracte à la surface de la cornée ou de la jonction cornéosclérale adjacente. La poignée maintient la position angulaire des extrémités de marquage à la cible stérile et projette une lumière de fixation du regard, des lignes d'alignement sur la cible stérile et un frein de cadran d'axe pour faciliter le placement des marquesur de la cornée.

Utilisation prévue : Le RoboMarker G2 (RMSG2) et le RoboTip G2 (TPSG2) sont utilisés conjointement en tant que système de marquage du tissu cornéen. Le système place des marques très précis sur la cornée et la jonction cornéo-sclérale périphérique pour l'alignment des lentilles intraoculaires tertiaires, la chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde, les incisions de relaxation limbique et d'autres interventions oculaires réfractaires.

Caractéristiques :

- Physiques : 25 mm X 39 mm X 8 mm ; 1 g.
- Matériau : Formule propriétaire d'encre sèche à base de violet de gentiane (crystal violet) et de carbone sur une surface en polycarbonate et un bouchon protecteur en XPLÉ.
- Emballage : Sachet scellé en papier synthétique avec encoches à déchirer.
- Géométrie des marques :
 - Cornée : lignes de 1,2 mm espacées par une zone optique interne de 1,5 mm.
 - Sclérale : lignes de 1,2 mm espacées par une zone optique interne de 12 mm.
- Stérilité : Irradiation, Gamma, ISO 11137 VDmax25.

Identification des pièces

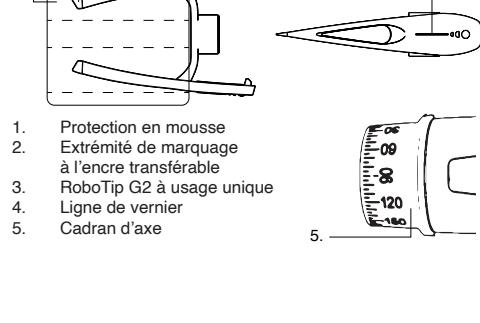

Surgilum, LLC Modèle TPSG2(RoboTip G2), Surgilum, LLC Modèle RMSG2(RoboMarker G2) - Trans - Bédo - Vendre

Usage

축소합니다 RoboTip G2 상자를 구입해 주셔서 감사합니다. 최상의 사용 결과를 얻으려면 이 지침을 주의 깊게 읽어주십시오.

설명: 일회용 TPSG2 RoboTip은 재사용 가능한 RMSG2 RoboMarker 핸들과 함께 사용하여 각막 또는 임파크트(크리스탈 바이올렛) 영역에 민감하거나 알레르기 있는 환자에게는 ROBOMARKER G2, ROBOTIPS G2를 사용하지 마십시오.

경강각 각막에 G2 ROBOMARKER 시스템을 사용하십시오. 유리에 사용하지 마십시오.

주의:

• RoboMarker G2는 의료 전문가만 사용해야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2는 임상 환경에서만 사용되어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.

주의: RoboTip G2는 매우 민감한 재료입니다. 사용 당시 까지 면역 청정 절차 및 페인팅이나 백화 처리 절차를 거친 후에만 사용하세요.

• 맨큐 세우치는 환자의 눈에 미친 영향을 예측하기 위해 주의해 주어야 합니다.

• RoboMarker G2 및 RoboTip G2를 의도된 용도로만 사용하세요.

• 일회용 RoboTip G2는 감마 방사선을 통해 백화 처리되어 일회용입니다. 재사용하거나 한 번 이상의 환자에게 사용하지 마십시오.

• 맨큐 세우치가 손상된 경우 RoboTip G2를 사용하지 마십시오.

호환성: RoboTip G2는 RoboMarker G2 핸들(Surgilum, LLC)에서 생산 및 별도 판매/판매 환경입니다. RoboMarker G2 또는 RoboTip G2를 다른 마킹 시스템과 함께 사용하지 마십시오.